GERMIPHENE MD

Une division de Young Innovations

CATALOGUE DE PRODUITS

La SÉCURITÉ
est notre spécialité

Depuis 1952, Germiphene fixe des normes d'excellences en matière de fabrication et de distribution de produits pour le secteur des soins de santé et dentaires, en particulier en ce qui a trait au contrôle des infections. Notre mission est de vous aider à parvenir aux résultats cliniques que vous souhaitez d'une manière compétente, bienveillante et efficace. Nous voulons nous assurer que votre cabinet est bien équipé pour répondre aux besoins complexes de vos patients et de votre personnel tout en respectant les directives provinciales, y compris les protocoles et procédures liés à la COVID-19.

Pourquoi Germiphene?

- Germiphene est certifié ISO (organisation internationale de normalisation) en plus d'être conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Nous avons instauré un système de gestion de la qualité afin de garantir la satisfaction de nos clients et la qualité de nos produits grâce à des améliorations constantes.
- Nos équipes des ventes permanentes sont compétentes et maîtrisent les dernières applications cliniques en plus d'être en mesure de fournir des informations de pointe pour assurer la croissance et le succès de votre cabinet.
- Nous offrons des services réputés qui comprennent un processus fluide de transition de fournisseurs, des tarifs transparents, des garanties de produits, des essais de produits, des tutoriels en ligne et des offres promotionnelles.

Notre objectif est d'établir des relations étroites fondées sur la confiance, les faits et un service d'assistance à la clientèle exceptionnel, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. S'associer à nous est simple! **Appelez-nous au 1 800 265-9931, envoyez-nous un courriel à info@germiphene.com ou visitez notre site Germiphene.com**

TABLE DES MATIÈRES

Prévention des infections 6
Surfaces dures ..... 6 à 7
Surfaces souples 8

Retraitement d'instruments 9
Prétraitement 10
Nettoyage ..... 11 à 13
Lubrification 14
Emballage ..... 14 à 15
Vérification de la stérilisation ..... 16 à 17
Désinfectant et stérilisant de haut niveau ..... 17 à 18

Évacuation et ligne d'eau 19
Nettoyage de système d'évacuation 19
Vérification et nettoyage de la ligne d'eau ..... 20 à 21

Santé bucco-dentaire 22
Fluorures 22
Rince-Bouche Antimicrobien 23
Soins bucco-dentaires à domicile 24
Anesthésiques topiques 24
Produits pharmaceutiques généraux 25

Soins et hygiène des mains 26
Savons 26
Nettoyants antiseptiques 27

Usage unique 28

GERMIPHENE MD

Les produits concentrés sont des solutions économiques et écologiques qui permettent d'économiser de l'argent et de l'espace d'entreposage.

L'activateur d'enzymes améliore les produits de lavage en dégradant les substances volumineuses et tenaces en petits morceaux plus faciles à enlever. Un résultat supérieur, même pour les substances organiques difficiles à nettoyer.

Les produits partenaires vont de pair. Nous recommandons de les utiliser ensemble pour des résultats optimaux.

Les informations dans ce catalogue reflètent les « pratiques exemplaires » ainsi que les normes et les lignes directrices en matière de contrôle et de prévention des infections au moment de la publication. Reportez-vous toujours aux normes et lignes directrices applicables à votre domaine d'exercice.

GLOSSAIRE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

- Sans alcool
- Sans colorant
- Sans gluten
- Avec xylitol

SAVEURS ET FRAGRANCES

- Menthe
- Fraise
- Menthe citronnée
- Cerise
- Framboise
- Menthe verte
- Linge frais
- Citron
- Gingembre et citron
- Camomille
- Sans fragrance ou sans saveur
- Mandarine
- Herbes

Germiphene conseille avec succès les cabinets dentaires sur la prévention et le contrôle adéquats des infections depuis plus de 65 ans. Nous sommes souvent témoins de la difficulté des cabinets à trouver un équilibre entre le coût des fournitures et une prévention complètes et conformes des infections. Seul Germiphene peut apporter les réponses à vos besoins complexes. Nous fournissons un service complet d'enseignement, de soutien et de formation à votre personnel, reflétant votre engagement global envers la sécurité de vos patients et de votre personnel. Nos produits permettent à votre équipe d'assurer la conformité avec un minimum de temps et de coûts.

Notre objectif est d'établir des relations étroites fondées sur la confiance, les faits et un service d'assistance à la clientèle exceptionnel, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Formations et service de soutien de pointe

- Obtenez des crédits de formation continue pour chaque séminaire « Formation Continue Sur Demande » virtuel ou en personne.
- Connectez-vous directement de votre domicile ou de votre bureau.
- Il n'est plus nécessaire de sacrifier votre productivité ou de coordonner vos dîners.
- Soyez au courant des dernières procédures et protocoles de PCI.
- Suivez des formations de PCI et réalisez les évaluations en cabinet.
- Assistez à des séminaires en ligne de PCI.

GERMICIDE³ | Nettoyant désinfectant multisurfaces

Peut être utilisé sur les surfaces dures et souples.

- Un désinfectant de surface 2 en 1 pour nettoyer et désinfecter
- Temps d'élimination à large spectre de trois minutes
- Bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide
- Virucide contre les virus non enveloppés difficiles à éliminer, tels que la polio
- Contient peu d'alcool et possède un pH neutre
- Idéal pour désinfecter TOUTES les surfaces y compris le matériau à empreinte

SOLUTION	LINGETTES ORDINAIRES (160 lingettes)	FRAGRANCE
3,78 L	Taille : 15 cm x 17 cm	
9,46 L	Sachet de lingettes de recharge	

GERMXTRA | Désinfectant pour les surfaces dures

- Bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide
- Virucide contre les virus non enveloppés difficiles à éliminer, tels que la polio
- Une formule au pH neutre pouvant être utilisée avec la plupart des métaux, plastiques et caoutchouc
- Un mélange synergétique d'éthanol (alcool éthylique) et de surfactants qui nettoie et désinfecte
- Nommé le produit le plus efficace sur le marché depuis plus de cinq ans par un organisme indépendant de test de produits dentaires*

SOLUTION	FRAGRANCE
4 L	

Temps d'élimination à large spectre

* Le rapport du clinicien peut être obtenu sur demande.

ULTRA SWIPES | Lingettes désinfectantes pour les surfaces dures

- Bactéricide, mycobactéricide (tuberculocide), fongicide et virucide
- Virucide contre les virus non enveloppés difficiles à éliminer, tels que la polio
- Une formule au pH neutre pouvant être utilisée avec la plupart des métaux, plastiques et caoutchouc
- Sans résidus ni démarcations

LINGETTES ORDINAIRES (160 lingettes)
Taille : 15 cm x 17 cm
Sachet de lingettes de recharge

Temps d'élimination à large spectre

SUPER GERMIPHENE | Nettoyant et désinfectant concentré

- Pour les surfaces dures non poreuses, comme le métal, l'acier inoxydable, la porcelaine, le plastique, les planchers et les murs
- Pour le prétrempage d'instruments
- Excellente compatibilité avec tous les instruments
- Idéal pour désinfecter les pierres ponces
- Bactéricide, fongicide et virucide
- Un désodorisant à double action et un nettoyant remarquable

SOLUTION	DILUTION
454 ml	4 L
2 L	250 L
4 L	

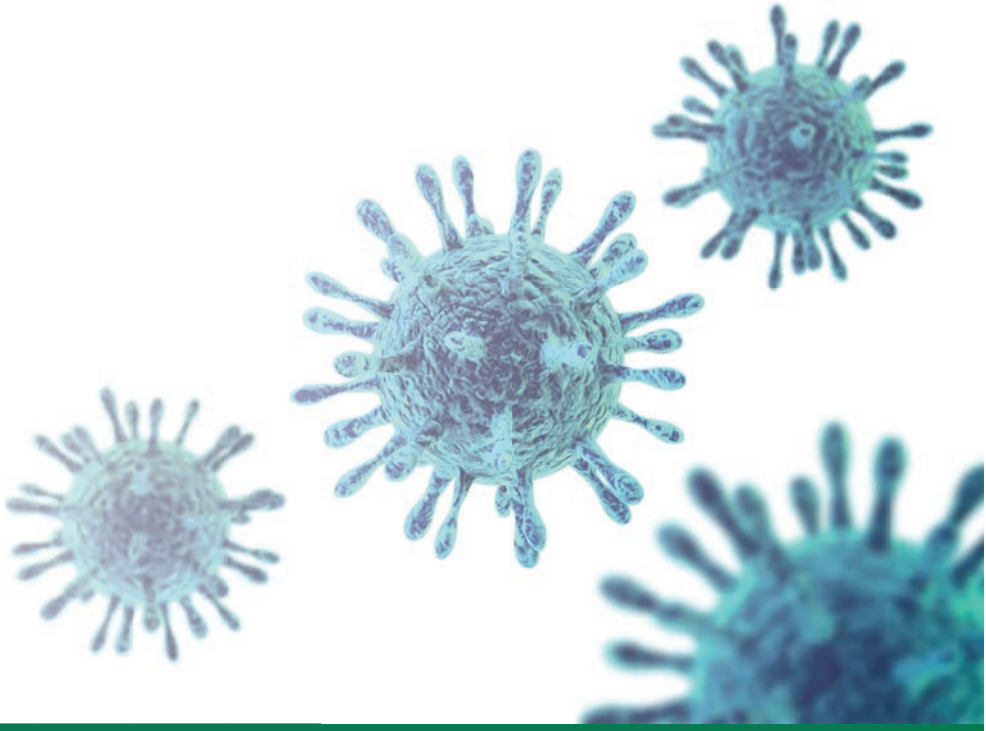

GENIE PLUS | Désinfectant et nettoyant pour chaise

- Nettoie, désinfecte à bas niveau et revitalise les chaises
- Nettoie et polit le Naugahyde[MD], le plastique stratifié, le vinyle et le cuir
- Aucun résidu collant ou glissant
- Élimine les accumulations de saletés laissées par d'autres solutions
- Ne fait pas craqueler et n'assèche pas le capitonnage
- Élimine la graisse et l'huile

★★★½

A obtenu un score de 3,5 sur 4 dans les essais pratiques cliniques

SOLUTION	LINGETTES ORDINAIRES (160 lingettes)
1 L	Taille : 15 cm x 17 cm
4 L	Sachet de lingettes de recharge

SANS ALCOOL

LES DÉSINFECTANTS DE SURFACE NE SONT PAS TOUS ÉGAUX!

Utilisez-vous le meilleur produit?

Votre produit actuel répond-il aux critères suivants :

1. Nettoie ..... ☐
   (une surface doit être propre pour être désinfectée)
   Désinfecte ..... ☐
2. Fournit des instructions pour ..... ☐
   l'utilisation prévue
3. Contient un numéro d'identification ..... ☐
   de médicament (DIN)
4. Possède une date de péremption..... ☐
5. Indique la compatibilité avec les différentes..... ☐
   surfaces (les produits ne peuvent pas tous être utilisés sur toutes les surfaces) ☐
   Convient aux surfaces dures ..... ☐
   Convient à différentes surfaces..... ☐
   Convient aux chaises..... ☐
6. Indique les groupes de microorganismes précis. ☐
   (un large spectre est essentiel)
   Tuberculocide ..... ☐
   Virucide (polio)..... ☐
   Fongicide ..... ☐
   Bactéricide..... ☐
7. Contient des ingrédients actifs ..... ☐
8. Fournit des avertissements et des mises ..... ☐
   en garde
9. Indique les conditions de stockage..... ☐
10. Précise l'équipement de protection..... ☐
    individuelle requis

Entretien et retraitement d'instruments

1 PRÉTRAITEMENT

- Les fabricants d'instruments recommandent des produits au pH neutre.
- Ne laissez jamais tremper les instruments toute la nuit ou pendant la fin de semaine.
- N'utilisez jamais de désinfectant ou de stérilisant comme solution de maintien.
- Les instruments doivent demeurer humides pour éviter l'assèchement de la charge microbienne.

2 RINÇAGE

- Rincez les instruments pour éliminer la charge microbienne ou la solution restante.

3 NETTOYAGE

- Si un instrument n'est pas propre, il ne peut pas être stérilisé!
- Portez un équipement de protection individuelle adéquat.
- Séparez les métaux de nature différente.
- Vérifiez le bon fonctionnement de l'instrument.
- Au besoin, appliquez du détachant.
- Retirez l'alginate au besoin.

4 RINÇAGE ET SÉCHAGE

- Rincez et séchez les instruments.

5 LUBRIFICATION

- Prolonge la durée de vie des instruments.
- Aide à éviter les taches, la corrosion et l'immobilisation des charnières.
- Secouez les instruments pour retirer l'excès avant de les emballer.

6 EMBALLAGE

- Séparez les métaux de nature différente.
- Les instruments articulés DOIVENT ÊTRE rangés en position ouverte ou déverrouillée.
- Ajoutez un indicateur chimique externe pour les instruments essentiels et semi-essentiels.
- Ajoutez un indicateur chimique interne conformément aux directives et normes provinciales.
- Stérilisateurs de classe B : utilisez une trousse de contrôle Bowie-Dick au quotidien (ou conformément aux directives et normes provinciales).

7 STÉRILISATION

- Indicateurs biologiques : faites des essais tous les jours ou toutes les semaines en fonction des directives et normes provinciales.

8 THERMOSENSIBILITÉ

- Les articles à usage unique ne peuvent être retraités.
- Prétraitez et rincez.
- Nettoyez les instruments manuellement ou à l'aide d'un dispositif automatique de nettoyage par ultrasons.
- Faites tremper les instruments dans un désinfectant ou stérilisant de haut niveau.
- Vérifiez l'efficacité de la solution en fonction du nombre d'utilisations indiqué sur l'étiquette d'instruction.

ET.FOAM | Mousse enzymatique pour le transport

La buse à mousse réduit les aérosols.

- Une solution de prénettoyage prête à utiliser pour instruments
- Les instruments souillés restent humides
- Idéale pour une utilisation avant les dispositifs de lavage d'instruments. * Rincez l'instrument avant de le placer dans un dispositif de nettoyage d'instruments ou de nettoyage par ultrasons.
- La formule non corrosive au pH neutre n'abîme pas la plupart des métaux, plastiques, caoutchoucs ou tuyaux annelés.
- Rinçage facile

SOLUTION	RECHARGE
1 L	4 L

GZYME³ | Nettoyant par ultrasons à triple enzyme

Un produit facile à mesurer dans un contenant pratique.

- Pénètre et élimine les substances organiques des instruments chirurgicaux et dentaires ainsi que sur les surfaces flexibles et rigides
- Décolle et dissout rapidement les dépôts protéiques
- Contient un agent bactériostatique pour éviter la croissance microbienne
- La formule au pH neutre est douce pour les instruments
- Une formule non corrosive, sans mousse et à rinçage facile
- Économique et très concentré

SOLUTION	FRAGRANCE	DILUTION
1 L		1 L 400 L

Utilisez-le avec Gleam II une fois par semaine pour redonner de la brillance à vos instruments.

LISTE DE VÉRIFICATION DU PRÉTRAITEMENT

- ☐ Utilisez un équipement de protection individuelle adéquat.
- ☐ Manipulez les instruments contaminés avec soin afin d'éviter toute exposition.
- ☐ Utilisez des contenants étanches adéquats pour les instruments souillés *(voir le Steri-Soaker à la page 15).*
- ☐ Si le nettoyage est retardé, gardez les instruments souillés humides à l'aide de gel, de pulvérisateur ou de mousse permettant de dégrader les taches (*voir ET.Foam ci-dessus)*.

GLEAM II | Solution de nettoyage par ultrasons

- Faites briller vos instruments
- Contient un agent bactériostatique pour éviter la croissance microbienne
- N'abîme pas les instruments en acier inoxydable
- Peut être utilisé sur du plastique, du verre et du caoutchouc

SOLUTION	RECHARGE	FRAGRANCE	DILUTION
2 L	10 L		2 L 200 L

Utilisez-la avec Gzyme³ pour un nettoyage en profondeur.

SUPER SONIC | Solution de nettoyage par ultrasons

- Formulée pour déloger et retirer des instruments dentaires les matières protéiques et organiques, telles que le sang, les mucosités et des tissus
- Contient un agent bactériostatique pour éviter la croissance microbienne
- Nettoie rapidement
- Une formule non corrosive contenant des inhibiteurs spéciaux d'oxydation qui n'abîme pas les instruments en acier inoxydable

DOSE UNITAIRE	SOLUTION	DILUTION	
48 sachets de 30 ml par boîte	1 L	1 BOÎTE 192 L	1 L 133 L

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE NETTOYAGE

- ☐ Utilisez un équipement de protection individuelle adéquat.
- ☐ Nettoyez vos instruments dès que possible.
- ☐ Démontez vos instruments conformément aux instructions du fabricant pour un nettoyage en profondeur.
- ☐ Inspectez chaque instrument afin de vérifier leur fonctionnement et leur propreté.

MICROVAC DE MICROBEX À DOUBLE USAGE | Solution de nettoyage par ultrasons et nettoyant de système d'évacuation

- Faites briller vos instruments
- Contient un agent bactériostatique pour éviter la croissance microbienne
- N'abîme pas les instruments en acier inoxydable
- Peut être utilisé sur du plastique, du verre et du caoutchouc

SOLUTION	DILUTION
4 L	4 L / 400 L

WASH CHECKS® U | Vérification du nettoyage par ultrason

- Vérifie régulièrement l'efficacité du processus de nettoyage de votre nettoyant par ultrasons
- Les souillures d'essai sur le dispositif se dissolvent lorsque les conditions de nettoyage sont efficaces
- Évitez les tests salissants avec du papier aluminium
- Le support est vendu séparément

DOSE UNITAIRE
50 bandelettes de vérification par sac



ENZO | Solution de nettoyage pour lave-instruments

Entreposage facile grâce au sac dans la boîte.

- L'activateur d'enzymes lutte fermement contre les débris organiques
- La formule sans phosphate vous permet de nettoyer de manière écoresponsable
- Une formule au pH neutre
- Une formule non corrosive et sans mousse
- Des résultats sans taches
- Aucun autre agent de rinçage nécessaire

SOLUTION	DILUTION	
3,78 L	3,78 L / 252 cycles	3,78 L / 31 jours 8 cycles par jour

* Basé sur des cycles de 15 ml

WASH CHECKS® | Vérification du nettoyage pour lave-instruments automatique

- Vérifie régulièrement l'efficacité du processus de nettoyage de votre lave-instruments automatique
- Les souillures d'essai sur le dispositif se dissolvent lorsque les conditions de nettoyage sont efficaces
- Le support est vendu séparément

DOSE UNITAIRE
100 bandelettes de vérification



TRÉS CLEAN | Nettoyant concentré pour porte-empreintes et instruments

Nettoie mieux que jamais et surpasse la concurrence!

- Formulée pour déloger et retirer des instruments dentaires les matières protéiques et organiques, telles que le sang, les mucosités et des tissus
- Contient un agent bactériostatique pour éviter la croissance microbienne
- Nettoie rapidement
- Une formule non corrosive contenant des inhibiteurs spéciaux d'oxydation qui n'abîme pas les instruments en acier inoxydable

SOLUTION	FRAGRANCE	DILUTION
1 L		1 L 20 L

REVIVE | Antirouille et détachant

- Redonne aux instruments leur apparence initiale.
- Améliore la durée de vie et l'efficacité des instruments en acier inoxydable.
- Réduit les coûts de remplacement d'instruments.
- Fait d'ingrédients d'origine naturelle.
- Bouteille de deux litres facile à utiliser permettant de verser et de mesurer

SOLUTION	DILUTION
2 L	2 L 25 L*

* Basé sur une utilisation régulière

LAIT CHIRURGICAL | Lubrifiant et inhibiteur d'oxydation pour instruments

- Garde les instruments brillants et évite qu'ils ne ternissent
- Sa perméabilité à la vapeur et sa capacité à être stérilisé ont été cliniquement prouvées
- Efficace avec la stérilisation à la vapeur, à sec ou chimique
- Réduit les coûts de réparation et de remplacement des instruments et lubrifie les charnières

DOSE UNITAIRE	DILUTION
2 L	4 L
4 L	20 L

CHEMDYE | Indicateur chimique de type 4

- Indicateur à plusieurs variables pour la stérilisation à la vapeur
- Le changement de couleur de bleu à noir est un indicateur permanent pouvant être consigné
- Les 250 bandelettes peuvent être divisées pour effectuer 500 tests

DOSE UNITAIRE
250 bandelettes de vérification par boîte

Peuvent être divisées pour obtenir 500 bandelettes de vérification par boîte.
* Au total, 250 bandelettes perforées de 20 cm ou 500 bandelettes de 10 cm

CHEMDYE BOWIE-DICK | Type 2

- Uniquement pour les stérilisateurs de classe B
- Vérifie l'efficacité de l'évacuation de l'air dans les stérilisateurs à vapeur à vide
- Conçu pour des cycle de 3,5 minutes à 134 °C ou de 4 minutes à 132 °C
- Changement de couleur permanent de mauve à vert
- Pour une utilisation quotidienne

DOSE UNITAIRE	RECHARGE
Trousse de démarrage : 120 cartes de test et un support à carte	120 tests par boîte

INDICATEUR / INTÉGRATEUR DE TYPE 5

- Réagit à toutes les variables critiques au processus de stérilisation (c.-à-d., le temps, la température et la présence de vapeur)
- Peut être utilisé en tant qu'outil de vérification supplémentaire afin de stériliser des charges qui NE CONTIENNENT PAS d'implants
- Des résultats faciles à lire : la barre foncée se déplace entre les zones « FAIL » et « PASS » pour faciliter la lecture

DOSE UNITAIRE
250 tests par boîte

SACHETS DE STÉRILISATION | Sachets de type 4 à plusieurs variables

- Sans latex
- Réagissent à deux variables critiques ou plus du cycle de stérilisation
- Contactez Germiphene ou votre représentant pour connaître les offres et la disponibilité.

FORMAT	QTÉ	FORMAT	QTÉ
2,25 po x 4 po	200	5,25 po x 10 po	200
2,75 po x 9 po	200	7 po x 13 po	200
3,5 po x 5,25 po	200	10,5 po x 17 po	100
3,5 po x 9 po	200	12 po x 18 po	100
5,25 po x 6,5 po	200		

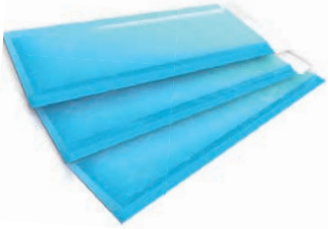

FACTEURS COURANTS INFLUENÇANT L'EFFICACITÉ DE LA STÉRILISATION

- Un nettoyage inadéquat des instruments
- Un emballage inadéquat
- Le mauvais matériel d'emballage pour la méthode de stérilisation choisie
- Une quantité excessive de matériel d'emballage
- Un chargement inadéquat du stérilisateur
- Une surcharge du stérilisateur
- L'absence d'une séparation entre les contenants ou les cassettes, même si le stérilisateur n'est pas surchargé
- Une durée ou une température inadéquate
- Une mauvaise utilisation du stérilisateur

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE NETTOYAGE

- ☐ Utilisez un équipement de protection individuelle adéquat.
- ☐ Nettoyez vos instruments dès que possible afin d'éviter que la charge microbienne ne sèche.
- ☐ Démontez vos instruments conformément aux instructions du fabricant pour un nettoyage en profondeur.
- ☐ Inspectez chaque instrument afin de vérifier leur fonctionnement et leur propreté.

B-SAFE | Programme de contrôle biologique de stérilisateur

Peut être utilisé dans un stérilisateur à vapeur, un stérilisateur à air sec ou dans un chemiclave.

- **Les résultats pour les stérilisateurs à vapeur envoyés par courrier sont obtenus 24 heures après la réception**
- **Les résultats peuvent être consultés en ligne**
- **Des trousses de test mensuelles, hebdomadaires et à usage unique sont offertes**
- **La trousse de 12 mois comprend un calendrier pour y apposer les étiquettes « PASS »**
- **Trousse à usage unique : 2 bandelettes de vérification et 1 bandelette de contrôle**
- **Trousse mensuelle : 2 bandelettes de vérification et 1 bandelette de contrôle**
- **Trousse hebdomadaire : 1 bandelette de vérification et 1 bandelette de contrôle**

TROUSSE À USAGE UNIQUE :	TROUSSE DE 12 MOIS
2 bandelettes de vérification et 1 bandelette de contrôle	24 bandelettes de vérification et 12 bandelettes de contrôle

Test de vérification à envoyer par la poste

STERISAFE | Programme de contrôle biologique de stérilisateur

Peut être utilisé dans un stérilisateur à vapeur, un stérilisateur à air sec ou dans un chemiclave.

- **Les résultats pour les stérilisateurs à vapeur envoyés par courrier sont obtenus 24 heures après la réception**
- **Résultats, formulaires et feuilles de registres accessibles en ligne**
- **Les trousses de 26 semaines et de 52 semaines comprennent des bandelettes et des enveloppes-réponses**
- **Une façon économique d'effectuer des tests toutes les semaines**
- **Chaque trousse contient : 1 bandelette de vérification et 1 bandelette de contrôle**

TROUSSE DE 26 SEMAINES	TROUSSE DE 52 SEMAINES
26 bandelettes de vérification 26 bandelettes de contrôle	52 bandelettes de vérification 52 bandelettes de contrôle

Test de vérification à envoyer par la poste et résultats en ligne

Respectez toujours les indications du manuel d'instructions du fabricant de votre stérilisateur lorsque vous l'utilisez.

GERMI-SAFE | Trousse de test de stérilité en cabinet

- Indicateur biologique pour la vérification de la stérilisation à vapeur en cabinet
- Résultats en 24 heures
- Un seul produit pour tous les cycles de vapeur
- Testez jusqu'à 14 stérilisateurs à la fois
- Un emballage pratique des fioles pour un entreposage ordonné et un contrôle facile des stocks
- Testez la stérilité en fonction des directives et normes provinciales
- Incubateur garanti à vie

TROUSSE DE DÉMARRAGE À INDICATEURS BIOLOGIQUES AUTONOMES (100 fioles)	FIOLES À INDICATEURS BIOLOGIQUES AUTONOMES
Incubateur, broyeur de fioles, carnet de notes (17), fioles à indicateurs biologiques	100 fioles par boîte
Recharges pour carnet de notes (25)	

Vérification en cabinet

STERI-SOAKER | Accessoire de stérilisation

- Plateau germicide à volume élevé pour nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments
- Compatible avec les nettoyants à enzymes et les détergents ainsi qu'avec les stérilisants et les désinfectants de haut niveau
- Le calendrier sur le couvercle permet de rappeler de manière efficace au personnel de changer la solution. Utilisez les anneaux à code de couleur pour indiquer les dates.

FORMAT
13⅞ po x 9 ⅝ po x 5 ⅛ po

Utilisez-le avec Gluterate, Lait Chirurgical, Très Clean, Revive, Super Germiphene et ET.Foam.

CIDETEST 1 GT[MC] | Bandelettes réactives pour évaluer la teneur en glutaraldéhyde

- Évalue facilement la concentration de glutaraldéhyde dans les solutions de stérilisation et de désinfection de haut niveau
- Facile à utiliser et donne des résultats rapides et clairs; il suffit de tremper une bandelette dans la solution
- Utilisez-les avec une solution de 1 à 2,5 % de glutaraldéhyde

DOSE UNITAIRE
50 bandelettes de vérification par bouteille

Utilisez-les avec une solution à 2 % de glutaraldéhyde.

ARRÊTER POUR TESTER

GLUTERATE | Solution stérilisante et désinfectante

- Solution à 2 % de glutaraldéhyde
- Solution prête à être utilisée : aucune mesure d'activation nécessaire
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide et sporicide
- Stérilisation en 10 heures et désinfection de haut niveau en 10 minutes
- Durée de conservation de deux ans pour la dose inutilisée
- Peut être utilisée sur tous les instruments et appareils médicaux et dentaires (lentilles, colles, plastiques, caoutchouc, acier, aluminium et laiton)

SOLUTION	1 UTILISATION	2 UTILISATIONS	4 UTILISATIONS
4 L	Bac de Trempage de 4 L 30 jours	Bac de Trempage de 2 L 60 jours	Bac de Trempage de 1 L 120 jours

Utilisez-le avec CideTest 1 et le GlutNeut pour neutraliser la solution avant de l'éliminer.

GLUTE NEUT | Neutralisant de glutaraldéhyde

- Écologique
- Une solution à une étape pour éliminer de manière sécuritaire le glutaraldéhyde
- Neutralisant à effet rapide
- Élimine les vapeurs et évite l'irritation des yeux et de la peau
- Change la couleur de la solution de jaune à rouge pour indiquer que la neutralisation a eu lieu

DOSE UNITAIRE	BOÎTE	1 SACHET
50 g	16 sachets de 50 g	50 g neutralise 1 L*

Utilisez-le avec Gluterate.

* De 2 à 2,5 % de glutaraldéhyde

Respectez toujours les indications du manuel d'instructions du fabricant de votre stérilisateur lorsque vous l'utilisez.

GOBBLE PLUS | Nettoyant de système d'évacuation

- Une combinaison écologique de bactéries produisant des enzymes qui dégradent et « consomment » les substances organiques immédiatement, ce qui permet d'obtenir des conduites d'aspiration propres et désodorisées
- Vendu dans une bouteille facile à utiliser permettant de verser et de mesurer* : mesurez, diluez et aspirez à même la bouteille
- Fonctionne en continu et produit des actions résiduelles entre les utilisations
- Ne contient aucun produit chimique corrosif ou dangereux
- Peu moussant et compatible avec les séparateurs d'amalgame
- Peut être utilisé sur du plastique, du métal ou des filtres à charbon
- Une formule douce au pH de 7 ±1

DOSE UNITAIRE	DILUTION
2 L	2 L
10 L	67 traitements

Les bouteilles permettant de verser et mesurer sont uniquement offertes en format de deux litres.

MICROVAC DE MICROBEX À DOUBLE USAGE |
Solution de nettoyage par ultrasons et nettoyant de système d'évacuation

- Un nettoyant polyvalent deux en un peu moussant et contenant plusieurs enzymes
- Retire de manière efficace les débris organiques, les charges microbiennes et les matières protéiques
- Une utilisation quotidienne permet d'éviter les coûts élevés liés aux réparations et aux temps d'indisponibilité
- Ce nettoyant économique sans phosphate n'est pas corrosif et neutralise les odeurs
- Flacon distributeur offert

DOSE UNITAIRE	DILUTION
4 L	4 L 400 L

E2O[MC] | Entretien des lignes d'eau dentaires et traitement choc

- Élimine le biofilm et les bactéries dans votre système d'eau sans produits chimiques nocifs
- Conçue spécifiquement pour être utilisée dans des systèmes indépendants de bouteille d'eau
- Une solution au pH neutre inodore, incolore et sans saveur
- Il suffit de la verser dans une bouteille d'eau à l'aide d'une pompe doseuse
- Sans mousse
- Sans résidus de comprimé qui pourraient obstruer les conduites

DOSE UNITAIRE	BOUTEILLE	BOUTEILLE
236 ml	700 ml 157 utilisations	2 L 52 utilisations

2 EN 1

Le biofilm dans les conduites d'eau peut obstruer le système de refroidissement dans vos pièces à main dentaires, ce qui peut entraîner des coûts élevés de remplacement.

E|LINE[MC] | Trousse de vérification de la qualité de l'eau

- Évalue la qualité de l'eau sur place à l'aide de fioles d'échantillonnage et d'un incubateur à blocs secs de 37 °C
- Traitez l'eau contaminée avec E2O[MC]
- Des résultats faciles à comprendre avec codes de couleurs

200 ufc/ml
Total des bactéries et des champignons

1 ufc/ml
E. coli et coliformes fécaux

TROUSSE DE CONTRÔLE INTÉGRAL E|LINE[MC]
18 tests par trousse : trois bouteilles de 250 ml d'E2O[MC], un traitement de ligne d'eau dentaire, un incubateur et un broyeur de fioles, total des bactéries et des champignons, E. coli et coliformes fécaux

TROUSSE DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU E|LINE[MC]
18 tests par trousse : un incubateur et un broyeur de fioles, total des bactéries et des champignons, E. coli et coliformes fécaux

FIOLES DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU E|LINE[MC]
12 tests par trousse : total des bactéries et champignons, E. coli et coliformes fécaux

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LA VÉRIFICATION ET LE NETTOYAGE DE LA LIGNE D'EAU

- ☐ Suivez toujours les instructions d'utilisation du fabricant.
- ☐ Les soins complets de lignes d'eau d'unités dentaires nécessitent un entretien continu de la ligne d'eau ainsi que des traitements de choc et de la surveillance.
- ☐ Le personnel doit respecter le protocole relatif à la ligne d'eau.

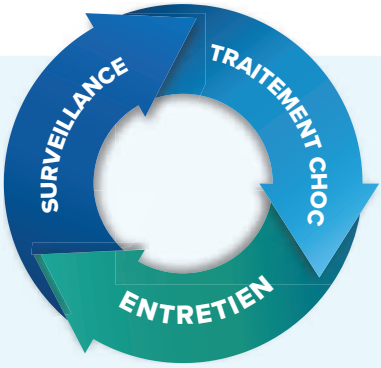

NEUTRARINSE | Rinçage buccal à 2 % de fluorure de sodium neutre

Une formule qui a bon goût!

- 200 utilisations par bouteille
- Une absorption de fluorure rapide en une minute
- Sans arrière-goût amer ou aigre
- Aide à prévenir les caries
- Une formule au pH neutre
- Recommandé pour les patients ayant des restaurations dentaires esthétiques ou en porcelaine, des couronnes et des ponts

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
2 L	

60 SECOND | Gel de fluorure topique

- 75 utilisations par bouteille
- 1,23 % d'ion fluorure (fait de fluorure de sodium et d'acide fluorhydrique)
- Une absorption de fluorure rapide en une minute
- Ne coule pas, ce qui évite les haut-le-cœur pour les patients et limite l'ingestion du produit
- Recommandé pour les enfants et les adultes sans restaurations dentaires en composite ou en porcelaine, couronnes ou ponts

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
450 ml	

Utilisez-le avec les porte-fluor buccaux en gel de Germiphene.

GEL 7 | Gel de fluorure topique neutre

- 75 utilisations par bouteille
- 2 % de fluorure de sodium (pour administrer 1 % d'ion de fluorure dans une base en gel thixotrope)
- Une absorption de fluorure en quatre minutes
- Une formule au pH neutre
- Sans arrière-goût amer ou aigre
- Idéal pour les patients ayant des restaurations dentaires cosmétiques ou en porcelaine, des couronnes ou des ponts

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
450 ml	

Utilisez-le avec les porte-fluor buccaux en gel de Germiphene.

ORO CLEAR | Rinçage buccal à 0,12 % de gluconate de chlorhexidine

Idéal pour le rinçage avant et après toutes procédures

- Rinçage buccal de gluconate de chlorhexidine qui convient aux patients ayant une sensibilité à l'alcool
- Peut être utilisé entre les visites chez le dentiste dans le cadre d'un traitement professionnel contre la gingivite
- Aide à éviter les gencives rouges et enflées
- Aide à limiter le saignement des gencives
- Empêche la formation de nouvelle plaque

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
227 ml	
500 ml	
4 L	

ORO CLENSE | Rinçage buccal à 0,12 % de gluconate de chlorhexidine

Idéal pour le rinçage avant ou après toutes procédures

- Liquide de rinçage antimicrobien à large spectre
- Idéal pour le traitement de la gingivite
- Aide à éviter les gencives rouges et enflées
- Aide à limiter le saignement des gencives
- Empêche la formation de nouvelle plaque

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
227 ml	
500 ml	
4 L	

ORO-X | Rince-bouche antibactérien

- Assez doux pour une utilisation quotidienne
- Peut être utilisé comme base pour les dentistes qui souhaitent élaborer leur propre liquide à rinçage
- Contient du chlorure de cetylpyridinium

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
4 L	

Utilisez-le avec une solution de 20 % de gluconate de chlorhexidine.

SOINS BUCCO-DENTAIRES À DOMICILE

ORO NAF | Rinçage quotidien au fluorure anti-carie

- 0,023 % d'ion fluorure (fait de 0,05 % de fluorure de sodium)
- Idéal pour les patients sujets aux caries ou en orthodontie
- Sans alcool

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
500 ml	

ANESTHÉSIQUES TOPIQUES

ZAP | Gel anesthésique topique

Le distributeur unique à une seule pression limite les risques de contamination croisée

- Une anesthésie rapide et à longue tenue
- Contient 18 % de benzocaïne et 2 % de tétracaïne
- Fait effet en 30 secondes et dure de 10 à 15 minutes
- Idéal pour la pose de digues de caoutchouc
- Nécessite seulement 0,2 ml de gel sur les tissus de la muqueuse

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
50 g	

STAT | Solution hémostatique

- 25 % de chlorure d'aluminium
- Agit rapidement pour arrêter les saignements gingivaux
- Sans épinéphrine (peut être utilisé sans effets secondaires indésirables)
- Solution à base aqueuse qui rend l'application plus rapide et plus simple qu'avec les produits à base d'éthylène glycol
- Facile et rapide à appliquer à l'aide d'un applicateur à embout en coton

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
15 ml	○

20 % DE GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE

Solution simple à utiliser

- Diluer au besoin avant l'utilisation
- Peut être utilisée comme additif dans les rinçages buccaux ou dans les préparations de cavités

DOSE UNITAIRE	SAVEUR
10 ml	○

✓ Utilisez-la avec la base de liquide de rinçage ORO-X.

MICROBEX VIROBEX-P | Nettoyant antimicrobien liquide pour les mains

- Contient 0,6 % de chloroxylène
- L'effet résiduel du PCMX dure plusieurs heures
- Enrichi d'émollients pour hydrater la peau
- Contient de l'aloès et de la lanoline
- Une fragrance fraîche herbacée
- Sans triclosan

DOSE UNITAIRE	FRAGRANCE
480 ml	
4 L	

VOS MAINS SONT-ELLES RÉELLEMENT PROPRES?

Zones les plus souvent oubliées

Zones oubliées moins souvent

Zones non oubliées

IC-GEL | Gel antiseptique pour la peau

- Large spectre
- Contient 70 % d'éthanol et d'émollients pour hydrater la peau
- Conçu pour être utilisé entre les contacts avec des patients afin de réduire les risques de contamination croisée
- Ne contient pas de colorant, ne tache pas et ne laisse pas de résidus
- S'évapore rapidement pour faciliter l'enfilage des gants

SOLUTION	DISTRIBUTEUR MURAL	FRAGRANCE
480 ml	Distributeur mural de 1 L	
946 ml*		
2 L	Cartouche de 1 L†	
4 L		

* La seule fragrance offerte est gingembre et citron. † La seule fragrance offerte est camomille.

IC FOAM | Mousse antiseptique pour la peau

- Désinfecte et hydrate en une seule étape
- Contient 70 % d'alcool éthylique
- Efficace contre les germes, mais assez doux pour un usage répété
- Une mousse stable et légère qui s'applique comme une crème
- Sèche rapidement pour faciliter l'enfilage de gants
- Non collant et non gras
- Une mousse sans aérosol et sans colorant qui ne tache pas

DOSE UNITAIRE	DISTRIBUTEUR MURAL
550 ml	Distributeur mural de 1 L
	Cartouche de 1 L

DEFEND® | Masques faciaux à double ajustement

Masques faciaux jetables de niveau 3 conformes à l'ASTM

CONTENU
50 masques par boîte

VOTRE MASQUE VOUS PROTÈGE-T-IL RÉELLEMENT?

- ☐ Votre masque devrait être ajusté autour des joues, des côtés du visage et sous le menton. Évitez les masques qui laissent des espaces permettant aux aérosols de contourner le filtrage.
- ☐ Respirez confortablement par le nez plutôt que par la bouche et évitez les fortes expirations.
- ☐ Changez de masque fréquemment. La surface du masque peut être contaminée dès la première inspiration. Il doit donc être jeté après chaque patient.
- ☐ Ne portez pas le masque de manière relâchée ou sous le nez. Ne touchez pas le masque, ne le descendez pas au niveau de votre cou et ne le réutilisez pas après l'avoir retiré.

TRUFIT™ | Gants en Nitrile

Gants Ultrafins en Nitrile Violet Trufit

- Doux et ajusté pour offrir un confort et une dextérité supérieurs
- La conception ultra-mince et durable offre une excellente sensibilité tactile
- Conception texturée des doigts pour une manipulation et une prise sûres
- Gants en nitrile de qualité médicale sans poudre ni latex

Gants Nitrile Bleu Ciel Trufit

- Ajustement confortable et conception texturée des doigts pour une meilleure sensation tactile
- Couleur élégante de bleu ciel
- Gants en nitrile de qualité médicale sans poudre

BOÎTE 300ct	BOÎTE 200ct
X-Small Violet Ultra-Mince	X-Small Bleu Ciel
Small Violet Ultra-Mince	Small Bleu Ciel
Médium Violet Ultra-Mince	Médium Bleu Ciel
Large Violet Ultra-Mince	Large Bleu Ciel
X-Large Violet Ultra-Mince	X-Large Bleu Ciel

COMPRESSES PURCOTTON

- Faites en coton doux 100 % naturel
- Sans chlore, poussière et peluche
- Résistantes à l'abrasion
- Hypoallergènes et autoclavables
- Possèdent de faibles charges bactériennes
- Biodégradables
- Très absorbantes

COMPRESSES de 2 po x 2 po	COMPRESSES de 4 po x 4 po
20 pochettes de 200 compresses = 4000 par boîte	10 pochettes de 200 compresses = 2000 par boîte

DAM IT! | Digues dentaires avec et sans latex

- Résistantes aux déchirures
- Contraste prononcé
- Non stériles
- Faible teneur en protéine
- Sans poudre
- Sans gluten

AVEC LATEX	SANS LATEX
52 digues de 5 po x 5 po par boîte (taille moyenne)	15 digues de 6 po x 6 po par boîte
36 digues de 6 po x 6 po par boîte (taille moyenne)	

PORTE-FLUOR EN GEL COMFORT FIT | Porte-fluor comfortable

- Faits de plastique à alvéoles fermées qui n'absorbe pas le produit sur les dents du patient
- Une conception basée sur l'anatomie qui évite les débordements et qui offre une couvrance égale à toutes les surfaces
- Comporte des prises pour faciliter l'insertion
- Les tailles sont différenciées par un code de couleur
- Sans latex

50 PORTE-FLUOR ARTICULÉ	100 PORTE-FLUOR SIMPLE/INDIVIDUEL
Petit : jaune	Petit : jaune
Moyen : vert	Moyen : vert
Grand : bleu	Grand : bleu

GANTGUARD[MC]| Bavettes dentaires

- 40 % plus larges que les bavettes ordinaires pour une plus grande surface de protection
- Résistantes aux liquides et aux taches. Protègent les vêtements des patients contre les taches et assurent que ceux-ci demeurent secs
- Découpées autour du cou pour offrir plus de confort au patient
- Non irritantes, non toxiques et ne laissent pas de résidus
- Le distributeur portable facultatif permet de garder les bavettes à portée de main
- Ne nécessitent pas de chaînes à bavettes
- Adhérent au patient

CONTENU
80 bavettes de 18 po x 22 po par rouleau et 8 rouleaux par boîte

CRYSTAL TIP® | Embouts de seringue air/eau

- Seringues à usage unique (jetables) qui aident à éliminer les risques de contamination croisée
- Une conception en deux parties pour une séparation complète de l'eau et de l'air
- Le contour mince offre une meilleure visibilité
- La rainure de verrouillage de l'embout empêche toute éjection accidentelle

FORMAT
250 par sac
1500 par sac

SCANNEZ CE CODE QR pour découvrir le fonctionnement des embouts de seringue air/eau Crystal Tip!

NOTES

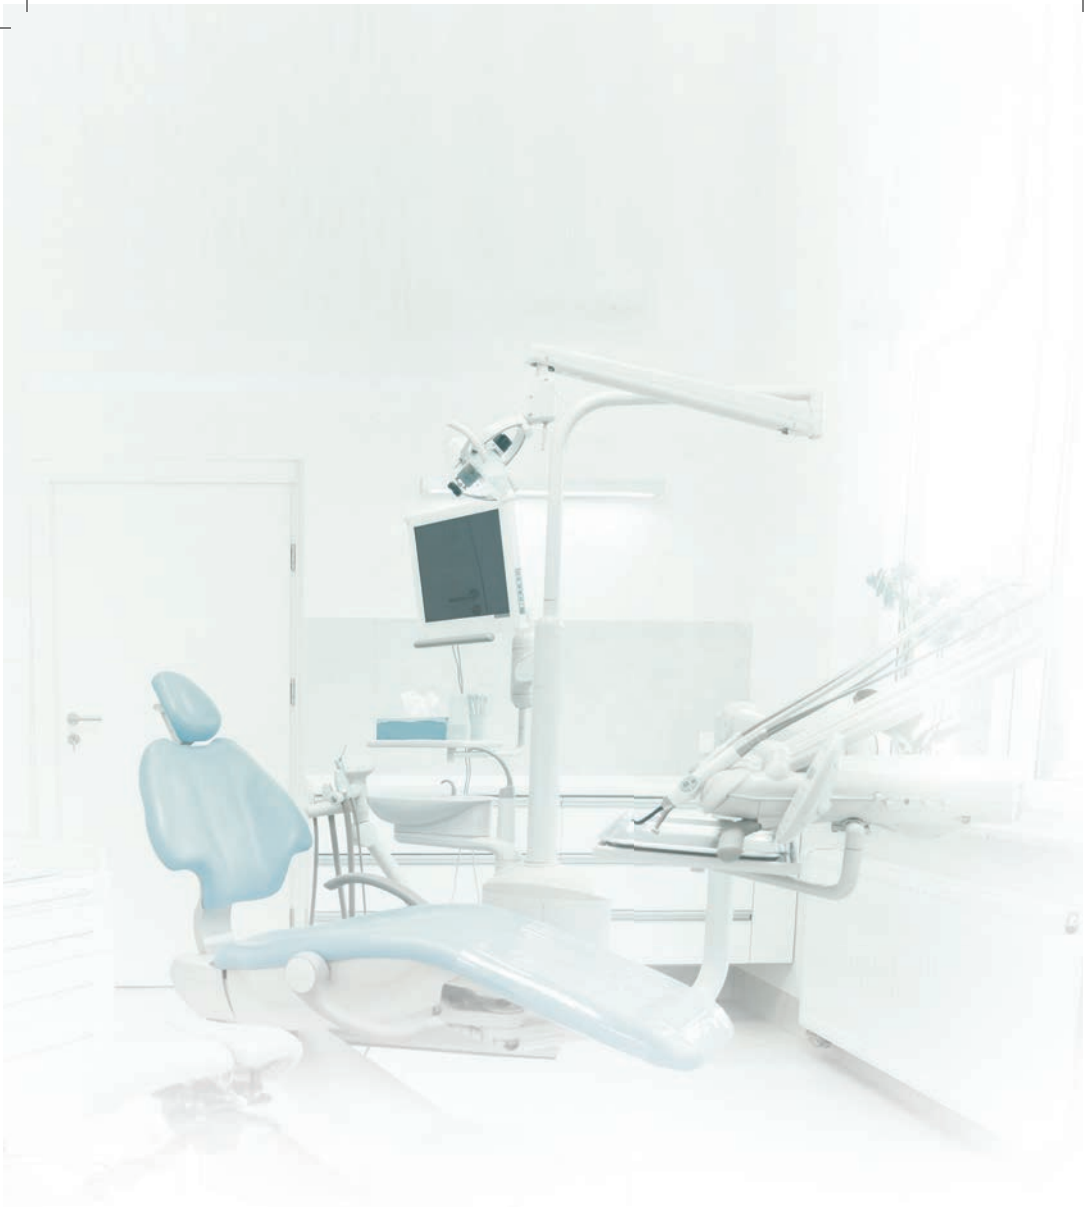

GERMIPHENE MD

Une division de Young Innovations

Pour plus de renseignements ou pour passer une commande, appelez le 1 800 265-9931 ou visitez notre site Web **www.germiphene.com**.